

HYPERFLUX

使い方マニュアル

 Hyperice

製品を安全にお使いいただくために、
使い方マニュアルと別紙の取扱説明書を必ずお読みいただき、
使い方マニュアルと取扱説明書は大切に保管ください。


保証書付

Ver:1.0


各部の名称と機能

仕様

- 1 電源ON/OFFボタン
- 2 時間調整ボタン
- 3 圧力調整ボタン
- 4 開始/一時停止ボタン
- 5 電源ポート
- 6 エア出口
- 7 ジャンクションボックス
- 8 ブロックプラグ
- 9 コネクタ

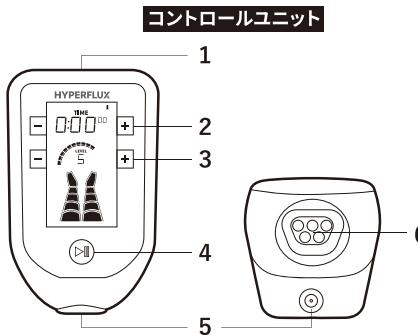


ホース

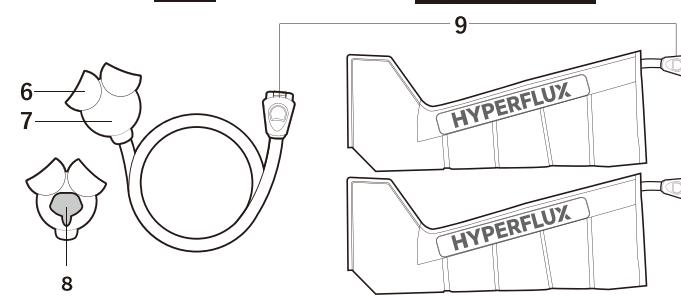

付属品


日本国内でご使用
は、typeAのプラグ
を取り付けてご使
用ください。




type A



type C



ブロックプラグ




使用しない場合は
エア出口にブロッ
クプラグを取り付
け、埃の侵入を防
いでください。

コントロールユニットのスクリーン表示


仕様

- A 充電残量インジケーター
- B 休憩時間インジケーター
- C セッション時間インジケーター
- D 加圧レベルインジケーター
- E 加圧ゾーンインジケーター

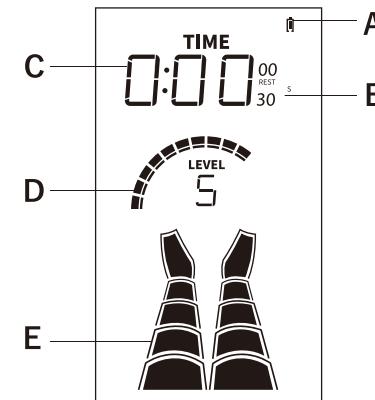

充電方法

充電は付属のHyperflux専用の充電器で
コントロールユニットをコンセントにつないでください。

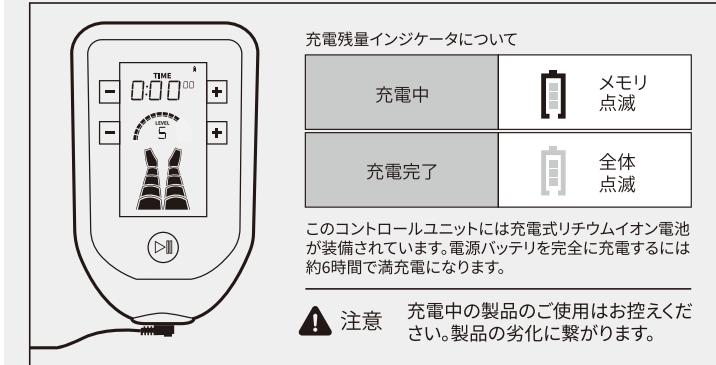

このコントロールユニットには充電式リチウムイオン電池
が装備されています。電源バッテリーを完全に充電するには
約6時間で満充電になります。

注意 充電中の製品のご使用はお控えください。製品の劣化に繋がります。

保証書

持込修理

品番	63000-001-00	お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日から 1 年間
お客様	ご住所 〒 _____ 電話番号 () - _____ お名前 _____				
販売店	JAN	JAN 4 54446 00483			

本書をお買上げ日から上記の期間中に故障が発生した場合、アフターサービスに記載の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。

- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、修理等の本製品に関わる業務においてのみ利用させていただきます。また、修理業務のために製造メーカーに提供する場合があります。
- 保証書と購入証明書(レシート・納品書)がない場合は保証期間内であっても保証対象外となります。
- 材料及び製造技術の欠陥以外の原因、取扱上の不注意、改造、不正修理等によって発生した不良におかれましては保証期間内であっても保証の対象とはなりません。
- 日本正規品以外(並行輸入品・模造品)は保証・不具合のサポート対象外となります。
- 修理・故障の際は、お買上げの販売店にご相談ください。修理は持込修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。■操作方法・組立方法・その他のお問合せはお買上げの販売店又はお客様ご相談センターにご相談ください。
- 消耗品は保証期間内であっても有償となります。詳しくはお客様ご相談センターへご相談ください。

長年ご愛用の製品の点検を	
	こんな症状はありませんか ■電源プラグ・コードが異常に熱い ■本体に変形がある、または異常に熱くなる ■コードに傷がある、またはコードを動かすと通電したりしながりたりする ■使用中に異常な音がする ■本体や部品にひび割れがある
	ご使用中止 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はお客様ご相談センターに点検をご相談ください。

【地球の環境保護の為、廃棄する時はそのまま放置せず、各自治体の取り決めに従ってください】

お客様ご相談センター
0120-980-997

受付時間：10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 16:00
月～金曜日
(祝日・年末年始・夏季休業を除く)


発売元：株式会社ツインズ

〒273-0853
千葉県船橋市金杉7-1-9ソインビルズ西館3F
TEL:047-449-8380 FAX:047-449-8381
URL: <http://www.twins-corp.com/>

ご使用方法

装着方法

コネクタを接続する

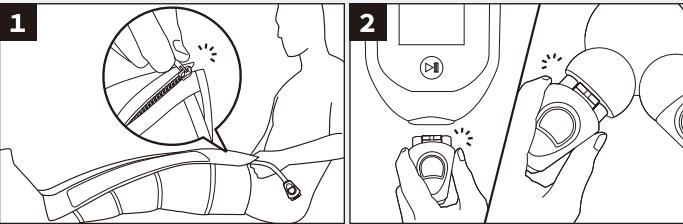

初めてリラックスできる姿勢をとり、レッグアタッチメントに足を片足ずつ入れます。


付け根部分に合わせて、ファスナーは最後まであげてください。

コントロールユニットのエア出口にホースのコネクタを接続してください。また、ジャンクションボックスにレッグアタッチメントのコネクタを接続してください。

コネクタは、カチッとなるまで差し込んでください。

電源を入れる

開始する

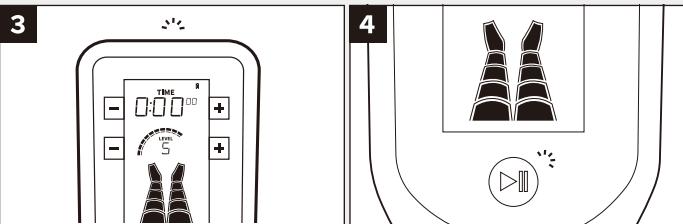


装着できたら、コントロールユニット上部にある電源ボタンを強めに押し、電源を入れます。

開始/一時停止ボタンをタップすると、セッションを開始します。

セッション中に、開始/一時停止ボタンをタップすればいつでも停止できます。

セッションの終了を確認する

コネクタを外す

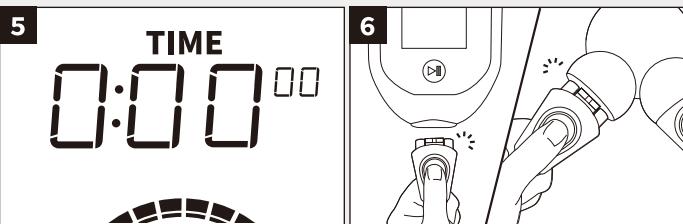

セッション時間インジケーターに 0:00:00 と表示されても、サイクルが一巡するまで動き続けます。

コントロールユニット、ジャンクションボックスから、コネクタ上部のボタンを押しながら引き抜きます。


⚠ 安全にお使いいただくために(重要)な注意事項

使用中にひどい痛みや気分が悪くなった場合や緊急時にレッグアタッチメントを取り外したい場合は次の手順を実行します。

- ・電源ボタンを押して、コントロールユニットを停止します。
- ・コントロールユニットまたはレッグアタッチメントからホースを外します。
- ・肢部からレッグアタッチメントを取り外します。
- ・必要に応じて、有資格の医療従事者に速やかに相談してください。

コントロールユニット操作方法

セッション時間の調整

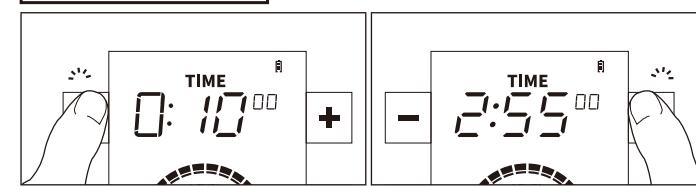


セッション時間インジケータの左右にある+、-ボタンを押して調整できます。

一度押して5分、長押しで増減のスピードを速めることができます。

セッション時間は、最短10分～最大2時間55分の間で設定できます。

セッションの実行中であっても、調整は可能です。

加圧レベルの調整

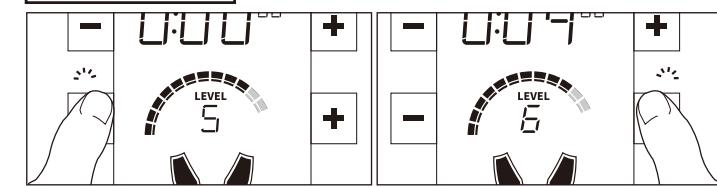


加圧レベルインジケータの左右にある+、-ボタンを押して調整します。

加圧レベルは、1～最大7まで。

加圧パターンは2種類あり、切り替えができます。

加圧パターンを切り替えるには、圧力レベルを7にした状態で、+ボタンを約5秒間長押しします。


Pulse モード



足元から軽めの圧迫が始まります。

選択部位の全体が圧迫される、人の手のまみほぐしのように、部分的に圧迫と解放を繰り返します。

SEQUENTIAL モード




足元から加圧し、順次加圧エリアが上へ移動しながら増えています。

*SEQUENTIAL MODE の表示が現れる

休憩時間の調整

編集モードに切り替える

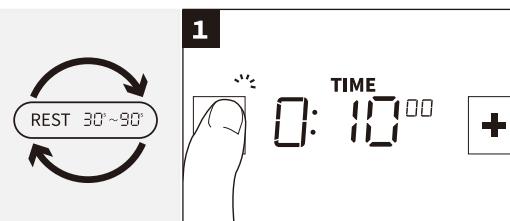

休憩時間とは


セッションが一巡した後、次のサイクルを開始するまでの休憩時間のことです。



編集モードへ切り替えるには、セッション時間を10分にした状態で、-ボタンを約4秒間長押しします。


加圧ゾーンの調整

編集モードに切り替える



加圧ゾーンとは


加圧する部位を足先～ももまでの5段階に分けて指定することができます。

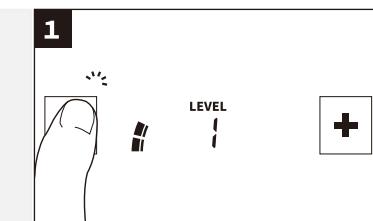

編集モードへ切り替えるには、圧力レベルを1にした状態で、-ボタンを約5秒間長押しします。

休憩時間を調整する

決定する

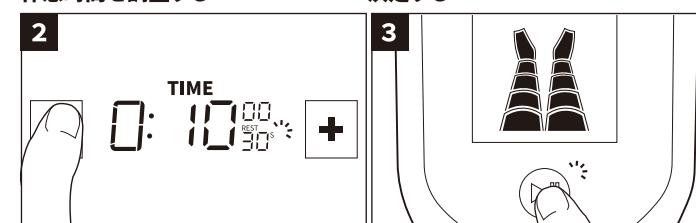

編集モードに入ると、休憩時間が画面右側に赤色で表示され、点滅します。

時間調節ボタンの+/-ボタンを押すと、休憩時間を15秒から90秒の間で設定できます。


(15秒単位で調整できます)

お好きな休憩時間を設定し、コントロールユニットの開始/一時停止ボタンを押します。

休憩時間が消えると設定完了です。

加圧ゾーンを選択する

決定する

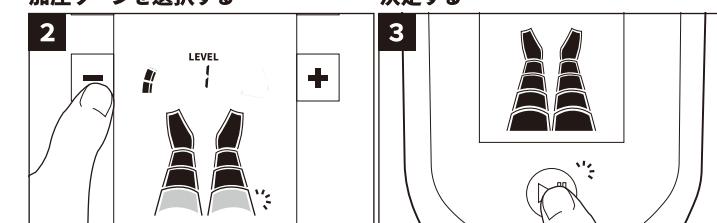

編集モードに入ると、加圧ゾーンインジケータが点滅し始はじめます。

加圧ゾーンインジケータの左右にある+/-ボタンを押して調整します。

お好きな加圧ゾーンを選択し、開始/一時停止ボタンを押します。

加圧ゾーンインジケータの点滅が消えると設定完了です。